

**GARA A PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI CANNULE VENOSE PER CHIRURGIA MINI-INVASIVA PER L'UOC DI CARDIOCHIRURGIA DELL'AZIENDA ULSS N. 8 "BERICA"**

**VERBALE DI VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA**

(VERBALE COMMISSIONE GIUDICATRICE N. 3)

**GARA N. 8083818 - CIG 867116253F  
ID SINTEL 136554538**

Alle ore 14:30 circa del 03/08/2021, in Vicenza, presso uno studio dell'UOC Cardiocirurgia dell'Azienda ULSS 8 Berica, si riunisce la Commissione Giudicatrice nominata con Deliberazione del Direttore Generale n. 996 del 27.05.2021 così composta:

Presidente: Dr. Alessandro Dacomo, Direttore dell'UOC Farmacia Ospedaliera di Vicenza dell'Azienda Ulss n. 8 "Berica";  
Commissari: Dr. Alessandro Favaro, Dirigente medico presso l'UOC di Cardiocirurgia dell'Azienda Ulss n. 8 "Berica";  
Dr. Renato Tonello, Coordinatore della sala operatoria presso l'UOC Cardiocirurgia dell'Azienda Ulss n. 8 "Berica".

Il Presidente dichiara aperta la seduta e ricorda che le attività di gara rivestono natura riservata e che ne è vietata la divulgazione.

La Commissione si riunisce dopo aver esaminato le campionature presentate dalle ditte Eurosets S.r.l. e Sorin Group Italia S.r.l..

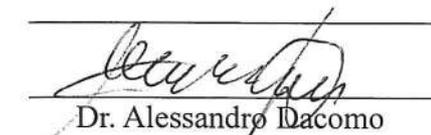
Procede quindi all'attribuzione dei giudizi sulla base dei criteri di valutazione di cui all'art. 18 del Disciplinare di gara, come da tabella allegata al presente verbale.

Le offerte delle ditte Eurosets S.r.l. e Sorin Group Italia non hanno superato la soglia di sbarramento relativa alla qualità, fissata in 42 punti nell'art. 18.1 del disciplinare di gara, e, pertanto, non vengono ammesse all'apertura dell'offerta economica.

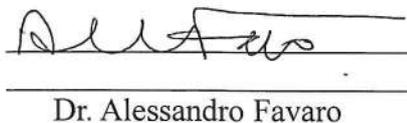
La seduta ha termine alle ore 15:30.

Il presente verbale, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE

  
Dr. Alessandro Dacomo

I COMMISSARI

  
Dr. Alessandro Favaro

  
Dr. Renato Tonello

All.: tabella excel

		EUROSETS S.r.l.				SORIN GROUP ITALIA S.r.l.			
N	Elementi di valutazione	punti max D	valutazio		valutazio		motivazione	motivazione	
			ne (coefficiente)	PUNTEGGIO ASSEGNATO	ne (coefficiente)	PUNTEGGIO ASSEGNATO			
1	Efficacia del drenaggio venoso durante la procedura endoscopica con retrazione dell'altro e ritorno venoso forzato con negativa di - 40mmHg	20	0,4	8	0,4	8	Drenaggio scadente anche con variazione della pressione negativa della CEC	Importante riduzione del drenaggio su minime variazioni della posizione della cannula	
2	Flexibilità e resistenza al kinking	10	1	10	1	10			
3	Ingombrò del confezionamento del kit e facilità di apertura sul campo operatorio	10	1	10	1	10			
4	Facilità di introduzione e fissaggio, anche in condizioni limite di emergenza	15	0,4	6	0,4	6	Cannula molto rigida. Presenza di scallino che rende difficile l'inserimento in vena femorale, soprattutto in condizioni di emergenza	Cannula molto elastica che rende difficile l'inserimento per via percutanea	
5	Maneggevolezza e flessibilità, facilità di posizionamento ecoguidato	15	0,4	6	0,4	6	Cannula poco flessibile e ad alto rischio di lacerazione venosa durante l'inserimento	Eccessiva flessibilità della cannula. Difficile il corretto posizionamento bicavale ecoguidato	